


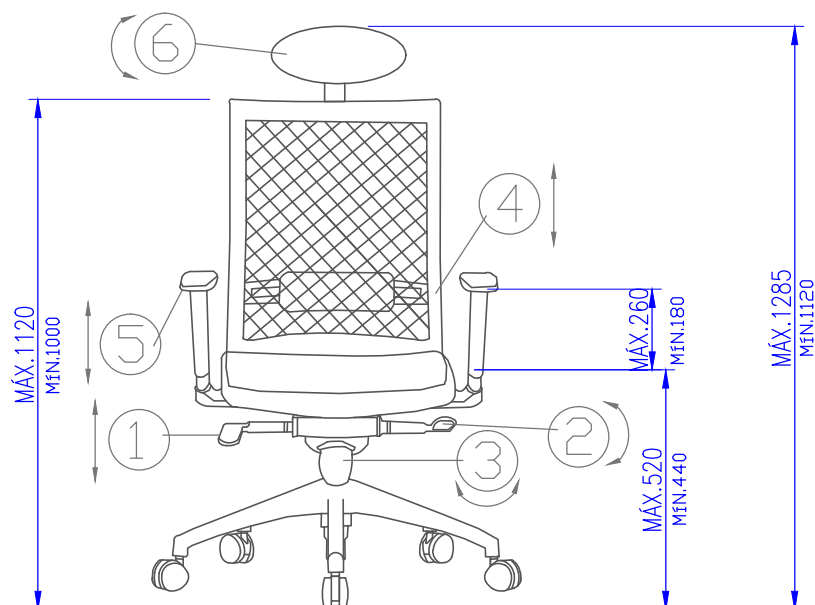

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① - AJUSTE DE ALTURA DE ASSENTO. | ④ - AJUSTE DE ALTURA DE APOIO LOMBAR. |
| ② - AJUSTE DE INCLINAÇÃO ASSENTO/ENCOSTO | ⑤ - AJUSTE DO APOIO DE BRAÇOS. |
| ③ - AJUSTE DE TENSÃO DE INCLINAÇÃO. | ⑥ - AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA. |

MEDIDAS EM MILÍMETROS (mm)

C2 - CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS

Especificações:

Assento - Em espuma de poliuretano flexível HR de alta resistência e alta resiliência; baixa fadiga dinâmica e baixa deformação e densidade controlada, moldada anatomicamente revestido em courissimo ou couro ecológico na cor "PRETO".

Encosto - Revestido em Mesh, com ajuste de inclinação, tensão de inclinação e lombar além de encosto para cabeça também ajustável.

Mecanismo da base - Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás, fabricada em tubo de aço de 1,50mm. Deverá ter 05 patas de aço cromadas. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e à base através de cone Morse.

Rodízio - Duplos com rodas de 50 mm de diâmetro e anti-risco.

Apoio de Braços - Removíveis, injetados em polipropileno, com suporte metálico de fixação em aço com regulagem telescópica de altura do apoio em, no mínimo, três posições de encaixe.

Obs.: 1 - Atentar para os ajustes solicitados através das numerações de 1 a 6.

2 - Esta cadeira deverá suportar, no mínimo 110 kg.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO			
TÍTULO MOBILIÁRIO DIRETORIA DE TECNOLOGIA - DTI - ANEXO II			FOLHA
ASSUNTO		ESCALA	
C2 - CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS		1:60	
		DATA	01/04/2016