


P1

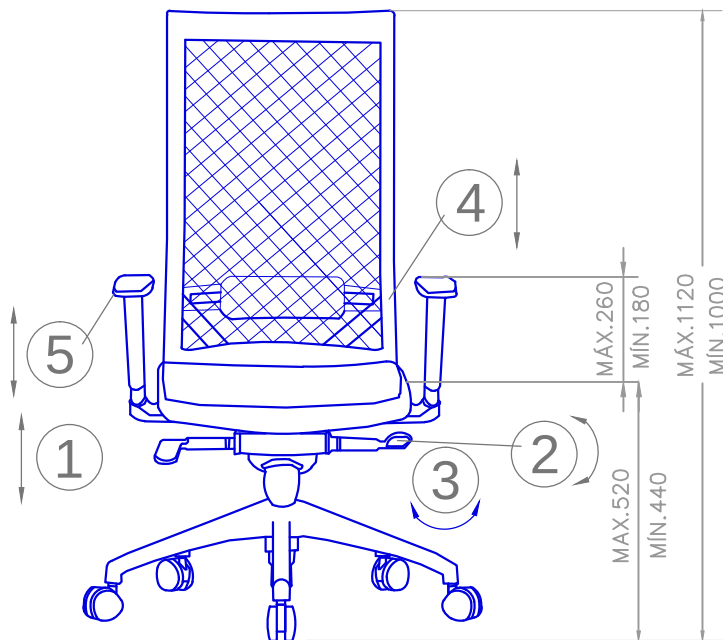

- ① - AJUSTE DE ALTURA DE ASSENTO.
- ② - AJUSTE DE INCLINAÇÃO ASSENTO/ENCOSTO
- ③ - AJUSTE DE TENSÃO DE INCLINAÇÃO.
- ④ - AJUSTE DE ALTURA DE APOIO LOMBAR.
- ⑤ - AJUSTE DO APOIO DE BRAÇOS.

Poltrona Giratória - Espaldar Alto

Assento - Em espuma de poliuretano flexível HR de alta resistência e alta resiliência; baixa fadiga dinâmica e baixa deformação e densidade controlada, moldada anatomicamente revestido em courissimo preto.

Encosto - Revestido em Mesh, com ajuste de inclinação, tensão de inclinação e lombar.

Mecanismo da base - Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso, fabricado em tubo de aço de 1,50mm. Deverá ter 05 patas de aço cromadas. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e à base através de cone Morse.

Rodízio - Duplos com rodas de 50 mm de diâmetro em resina de poliamida (PA6); eixo horizontal e vertical em aço trefilado 1010/1020.

Apoio de Braços - Removíveis, injetados em polipropileno, com suporte metálico de fixação em aço com regulagem telescópica de altura do apoio em, no mínimo, três posições de encaixe.

Dimensões: Ver desenho

QUANTIDADE: 1 unidade